

- >> Nouveau mode multi-cycle
- >> Lentille diamètre XL (12,3mm)
- >> Gaine de protection intégrale
- >> Garantie 4 ans

## MULTI-MODE | MULTI-INDICATION

### PHOTO-POLYMÉRISATION | 4 MODES |

- |   |  |
|---|--|
| > SOFT<br>750 mW/cm <sup>2</sup><br>10s + bip 5s      | > BOOST<br>2200 mW/cm <sup>2</sup><br>3s                           |
| > STANDARD<br>1200 mW/cm <sup>2</sup><br>20s + bip 5s | > NOUVEAU MULTI-CYCLE<br>BOOST SEQUENTIEL<br>10 x (3s ON + 2s OFF) |

GARANTIE  
4 ANS

### DIAGNOSTIC | 2 MODES |

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| > DIAGNOSTIC UV<br>LED UV | > TRANSILLUMINATION<br>LED Blanche |
|---------------------------|------------------------------------|

SPÉCIAL  
COVID-19



- > Nouvelle gaine de protection intégrale



VOIR LA VIDEO



- > Lentille diamètre XL !  
Idéal pour l'omnipraticité comme pour les sessions d'orthodontie



- > Ultra-résistante & légère  
Aluminium type aéronautique, ergonomique, maniable (21cm), très légère (95g)



- > Chargement sur base



- > Utilisation en continu avec 2<sup>e</sup> batterie + chargeur universel (option)

### RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS

<b>ULTI-G</b>	Lampe + Base-chargeur + Batterie + 2 protections oculaires + 100 gaines. Aluminium
<b>ULTI-N</b>	Lampe + Base-chargeur + Batterie + 2 protections oculaires + 100 gaines. Noir mat
<b>ULTI-G500</b>	Gaines de protection intégrale x500
<b>C-BAT</b>	Chargeur universel (option)
<b>BAT-3.7-L</b>	Batterie supplémentaire (option)


DM : classe I.



## ULTRA PERFORMANTE POLYMERISATION & DIAGNOSTIC

## ULTRA POLYVALENTE OMNIPRATIQUE & ORTHODONTIE


4 MODES PHOTO-POLYMERISATION			2 MODES DIAGNOSTIC		
SOFT	STANDARD	BOOST	BOOST MULTICYCLE	DIAGNOSTIC UV	TRANSILLUMINATION
⊗	⊗	●	⊗●⊗	⊗	●
●●●	●	●	●●●	●	⊗
●●●	●●	●●	●●●	⊗	⊗
10s	20s	3s	10x (3s ON + 2s OFF)	120s	120s

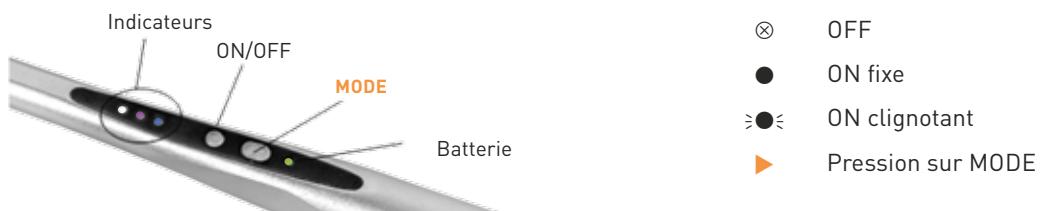

La lampe ULTIMA est constituée d'un manche d'une pièce sur lequel est scellé de façon étanche, un panneau de contrôle et une lentille résistante aux rayures.

Après chaque utilisation, essuyez la surface de la lentille avec une lingette ou une compresse imbibée d'un désinfectant anti-microbien. (cf Notice p.8)

Vérifiez régulièrement qu'aucun résidu de résine n'est présent sur la lentille.

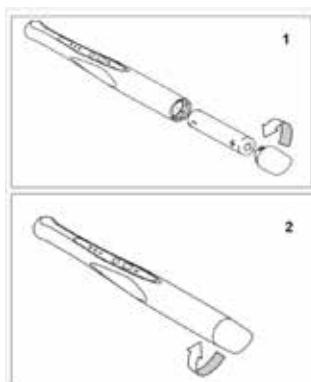

Remplacement batterie [BAT-3.7L]

Les protections intégrales à usage unique empêchent la contamination croisée et évite l'adhésion de composite ou résine dentaire à la surface de la lentille et du corps de la lampe.



Protection jetable intégrale [ULTI-G500]